
AUSTAR


Connecting Extraordinary Ideas

Беспроводная система проверки целостности перчаток с контрольной панелью AUSTAR KS-GTIS02-GC



Описание продукта

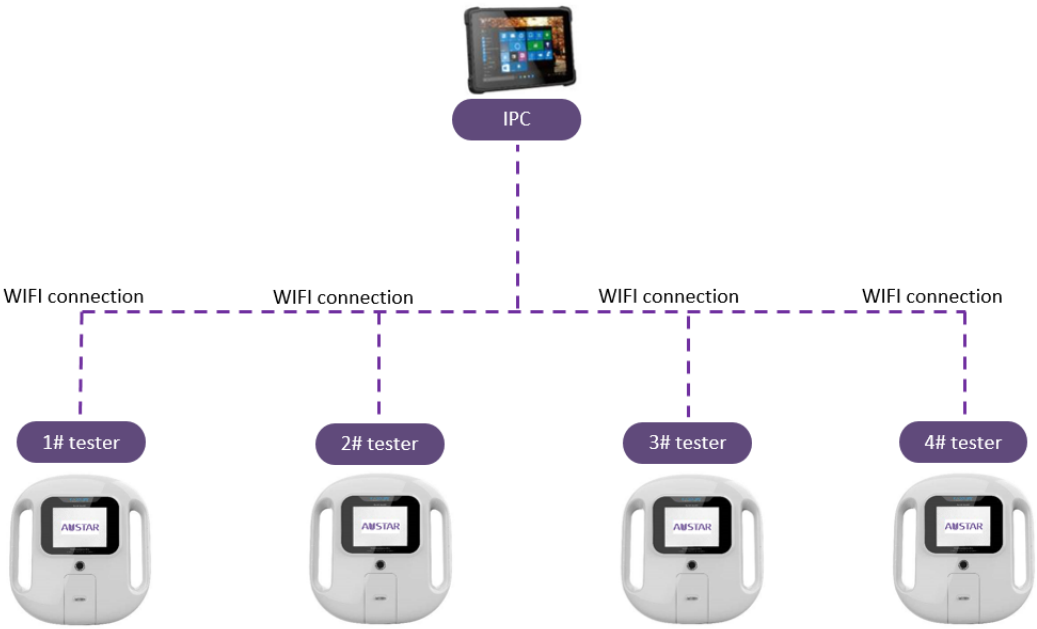


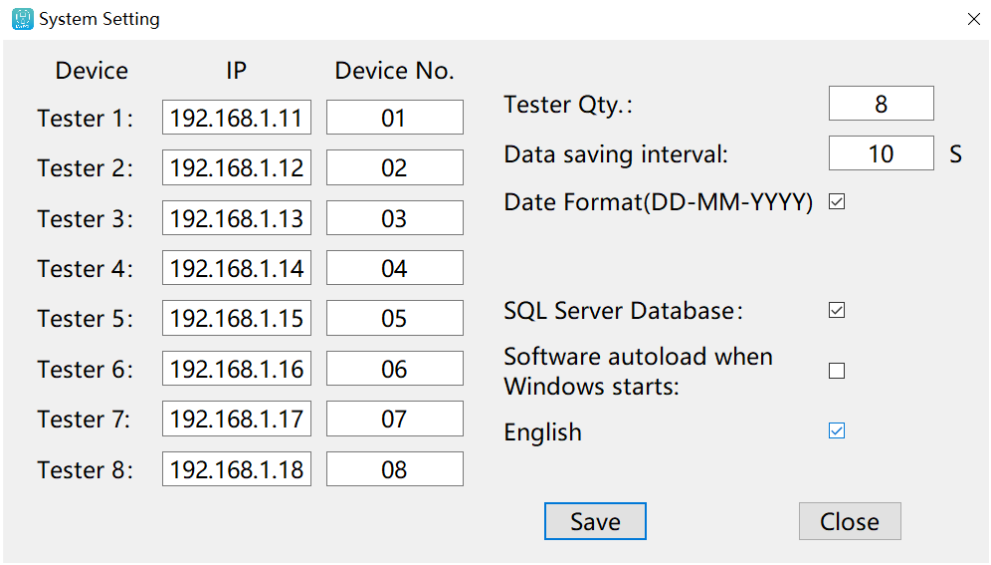

- ✓ Протокол связи поддерживает Modbus TCP.
- ✓ IP-адрес может быть настроен пользователем.
- ✓ Тестер герметичности перчаток может свободно переключаться между режимом хоста и вспомогательным режимом для соответствия различным задачам.


AUSTAR

Контрольная панель: программное обеспечение

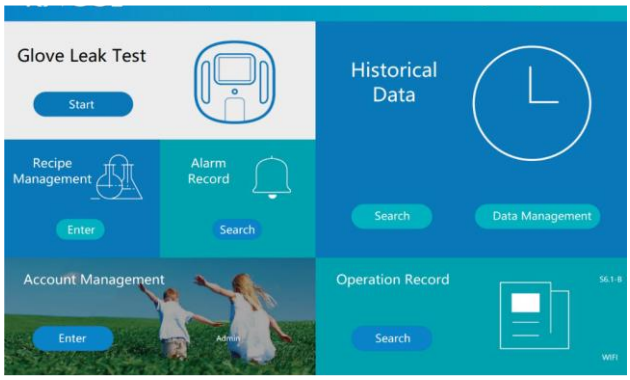


- ✓ PDF-отчет генерируется автоматически
- ✓ Резервное копирование и восстановление баз данных SQLite или SQL.Support
- ✓ Локальное или удаленное резервное копирование.
- ✓ Восстановление данных с SD-карты.

»»» Журнал аудита

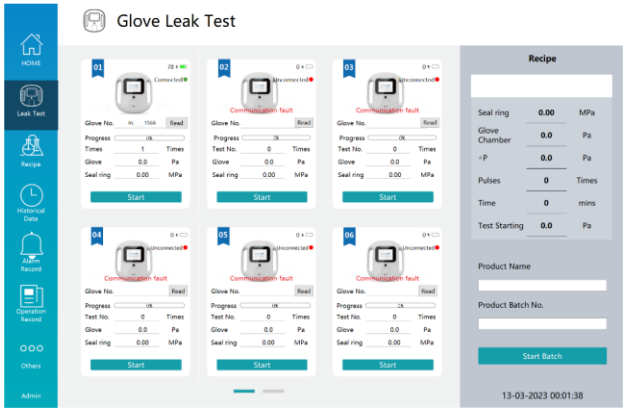


- ✓ Исторические данные, записи о работе, записи о тревогах, записи отчетов и список учетных записей могут быть резервно скопированы и восстановлены.
- ✓ Добавление записей о причинах.
- ✓ Записи журнала аудита могут быть отфильтрованы по определенным условиям для быстрого просмотра.

»»» Управление данными

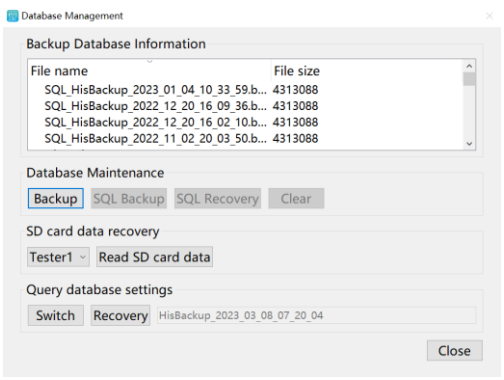



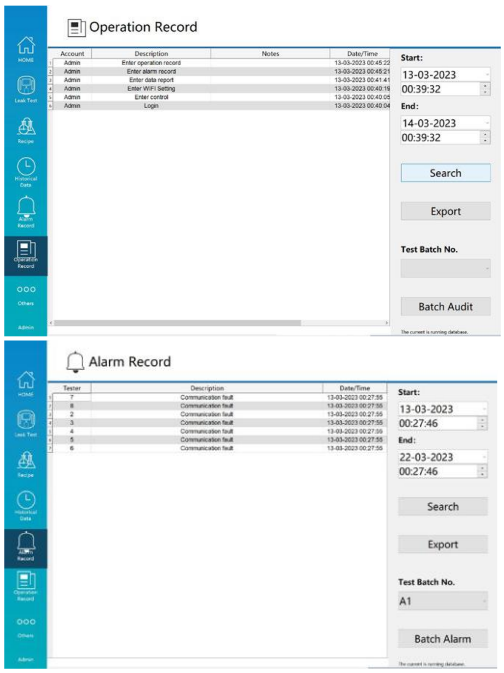


- ✓ Четыре уровня доступа к учетной записи
- ✓ Сложность пароля учетной записи: цифры,
- ✓ буквы верхнего и нижнего регистра, специальные символы;
- ✓
- ✓ Управление паролем учетной записи:

  · Минимальная длина может быть настроена.

  · Доступны параметры пароля, который необходимо изменить при первом использовании, и срок действия пароля.


- ✓ Активация и отключение учетной записи.


»»»Электронная подпись

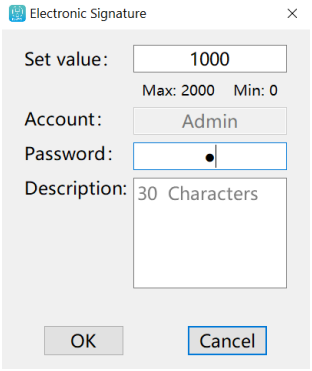


- ✓ Соответствие требованиям 21 CFR, часть 11
- ✓ Диапазон настроекDescription: record the

»»»» Управление учетными записями и безопасность

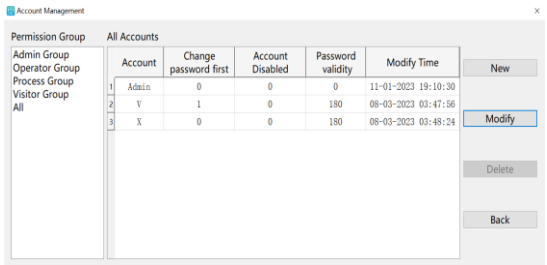


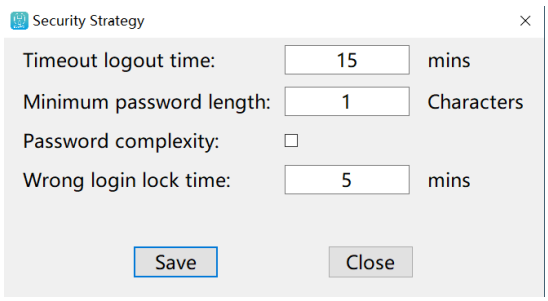

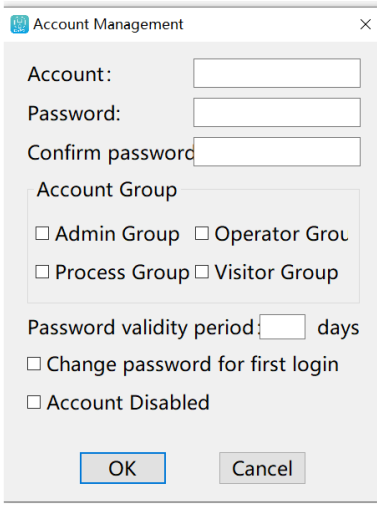

»»» Протокол испытаний

- ✓ Доступны как отдельные отчеты, так и пакетные отчеты.
- ✓ Отчеты по данным и отчеты по кривым объединены на одной странице.
- ✓ Формат PDF изменить нельзя.

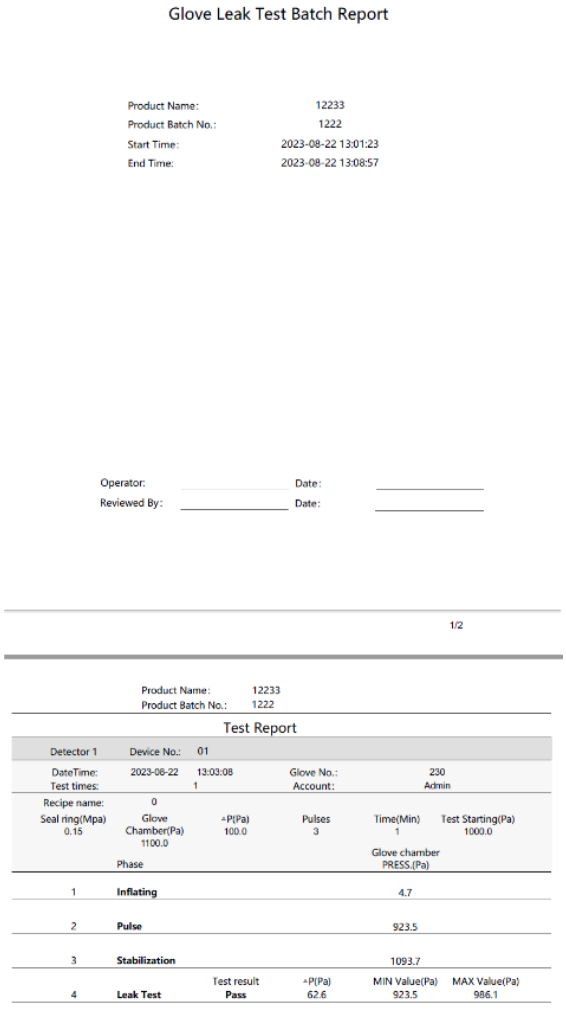

Glove Leak Test Batch Report

Product Name: 12233
Product Batch No.: 1222
Start Time: 2023-08-22 13:01:23
End Time: 2023-08-22 13:08:57

Operator: Date:
Reviewed By: Date:

1/2


Product Name: 12233
Product Batch No.: 1222

Test Report

Detector 1	Device No.: 01				
DateTime: 2023-08-22 13:03:08			Glove No.:	230	
Test times: 1			Account:	Admin	
Recipe name: 0					
Seal ring(Mpa) 0.15	Glove Chamber(Pa) 1100.0	ΔP(Pa) 100.0	Pulses 3	Time(Min) 1	Test Starting(Pa) 1000.0

	Phase	Glove chamber PRESS.(Pa)
1	**Inflating**	4.7
2	**Pulse**	923.5
3	**Stabilization**	1093.7

		Test result	ΔP(Pa)	MIN Value(Pa)	MAX Value(Pa)
4	**Leak Test**	**Pass**	62.6	923.5	986.1

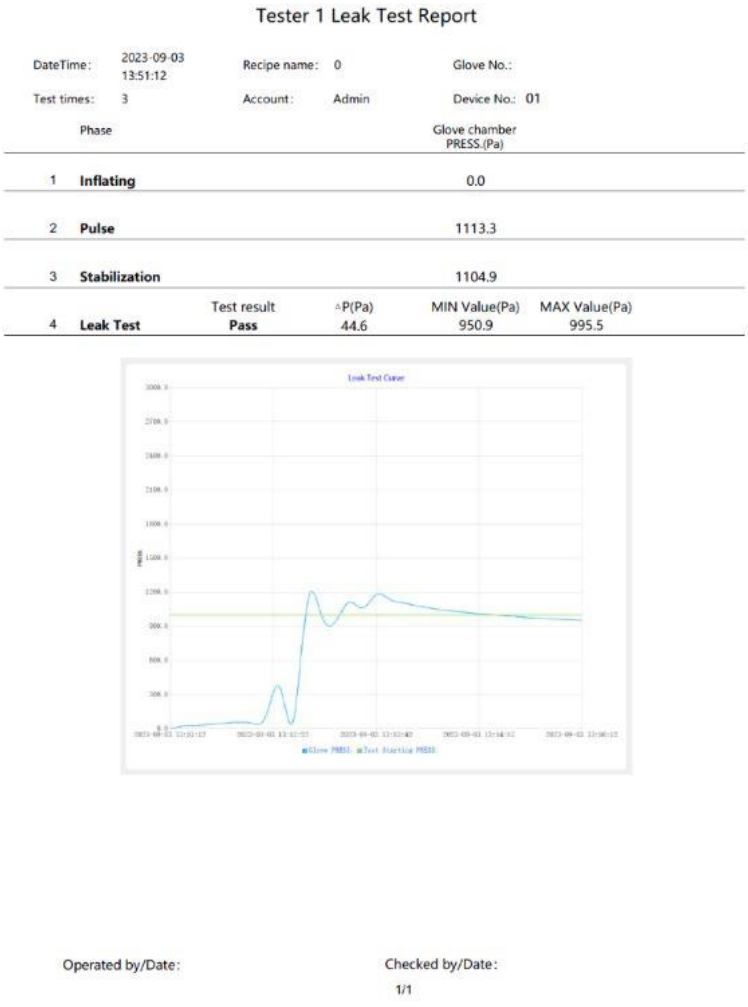

Tester 1 Leak Test Report

DateTime: 2023-09-03 13:51:12 Recipe name: 0 Glove No.:
Test times: 3 Account: Admin Device No.: 01

	Phase	Glove chamber PRESS.(Pa)
1	**Inflating**	0.0
2	**Pulse**	1113.3
3	**Stabilization**	1104.9

		Test result	ΔP(Pa)	MIN Value(Pa)	MAX Value(Pa)
4	**Leak Test**	**Pass**	44.6	950.9	995.5

Operated by/Date: Checked by/Date:

1/1

Сенсорный экран управления



- ✓ Начать надувание уплотнительного кольца
- ✓ Аварийная остановка
- ✓ Изменить IP-адрес тестера
- ✓ Считать номер перчатки (RFID)



»»» Резервные порты RJ45 и USB.

- ✓ Обновление программного обеспечения стало удобнее.

»»» Съемная литиевая батарея

- ✓ Простота в использовании
- ✓ Сертификация батареи завершена.







Технические параметры тестера

Model	KS-GITS02-GC	Weight	4kg
Size	306 ×328 ×105	WIFI	Available
Test flange size（inch）	7/8/10，Customizable	Power	Removable lithium battery
Operation time	3 hours	Charging time	≤3 hours

Контрольная панель

- ✓ Industrial Controlling Computer
- ✓ Windows 10
- ✓ IP 67

